

<別添1>

事務連絡

平成22年10月1日

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課殿  
独立行政法人国民生活センター・各消費生活センター殿

消費者庁消費者安全課

介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足  
などを挟む事故等に係る注意喚起について

平素より、消費者安全行政の推進に当たっては格別の御理解、御協力を頂きましてありがとうございます。

本年9月6日に、介護ベッド用手すりですき間に開いたグリップの内側に利用者の頭が入り、重傷を負う事故が発生しました。

事故の原因については現在、調査中ですが、当該製品は、平成4年から平成12年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したもので、グリップ部には縦が約15cm、横が約34cmのすき間がある構造でした。

そのため、同社は不意の動作により頭や首、手足がすき間に入り込むことを防止するため、平成13年10月から当該製品のすき間を埋めるためのT字型の簡易部品を無償で配布していました。

しかしながら、事故が発生した施設では、同社からの数度の連絡及び直接の文書の手渡しにもかかわらず、すき間を埋めるための簡易部品の入手をしていませんでした。

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッド用手すりでは、手すりのすき間に頭や首、手足など挟む事故等が、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度の施行(平成19年5月)から、これまでに7件(死亡2件、重傷5件(うち、本件事故と同様な内容の重傷事故1件を含む。))発生しています。

また、同社以外の製品を含む介護ベッド用手すり全体では、手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等が、これまでに計37件(死亡15件、重傷22件)発生しています。

消費者庁としては、同種事故の発生防止を図る観点から、介護ベッド用手すりの使用に係る注意点について、消費者の注意を喚起する必要があると認めますので、下記の事項について、消費者への周知及び注意の喚起をしていただきますようお願いいたします。

都道府県消費者行政担当課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知していただきますようお願いいたします。



## 記

### 介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について

#### 1. 事故事象及び再発防止策について

本年9月6日に、介護ベッド用手すりで外側に開いたグリップの内側に利用者の頭が入り、重傷を負う事故が発生しました。

事故の原因については現在、調査中ですが、当該製品は、平成4年から平成12年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したもので、グリップ部には縦が約15cm、横が約34cmのすき間がある構造でした。

そのため、同社は不意の動作により頭や首、手足がすき間に入り込むことを防止するため、平成13年10月から当該製品のすき間を埋めるためのT字型の簡易部品を無償で配布していました。

しかしながら、事故が発生した施設では、同社からの数度の連絡及び直接の文書の手渡しにもかかわらず、すき間を埋めるための簡易部品の入手をしていませんでした。

パラマウントベッド株式会社が製造した介護ベッド用手すりでは、手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等が、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度の施行（平成19年5月）から、これまでに7件（死亡2件、重傷5件（うち、本件事故と同様な内容の重傷事故1件を含む。））発生しています。また、同社以外の製品を含む介護ベッド用手すり全体では、手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等が、これまでに計37件（死亡15件、重傷22件）発生しています。

日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会においては介護ベッド用手すり等による事故等についての注意喚起及び安全使用の情報の普及をチラシやホームページ等を使用して両会及び会員事業者共同で実施するとともに、全国の福祉用具貸与事業者、居宅介護支援事業所を通じて利用者に伝達する取組みを行っています。

#### 事故事象

管理番号	A201000531
事故発生日	平成22年9月6日
報告受理日	平成22年9月21日
機種・型式	KA-089
事業者名	パラマウントベッド株式会社
被害状況	重傷1名
事故発生都道府県	神奈川県



事故内容	<p>施設で当該製品の外側に開いたグリップの内側に利用者の頭が入った状態で発見され、骨折と診断された。</p> <p>事故の原因については現在、調査中であるが、当該製品は、平成4年から平成12年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したもので、グリップ部には縦が約15cm、横が約34cmのすき間がある構造であった。そのため、同社は不意の動作により頭や手足がすき間に入り込むことを防止するため、平成13年10月から当該製品のすき間を埋めるためのT字型の簡易部品を無償で配布していた。製造事業者は無償配布の案内を当該施設に対して度々行っていたが、施設では簡易部品の入手を行っていなかった。</p> <p>なお、当該製品は、製造・出荷時の日本工業規格（JIS）に適合している。</p>
------	---

(日本福祉用具・生活支援用具協会)

ホームページ：<http://www.jaspa.gr.jp/news/080205.pdf>

(医療・介護ベッド安全普及協議会)

ホームページ：<http://http://www.bed-anzen.org/>

## 2. 消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、従来から、手すりの内側のすき間やベッドとの間に生じる外側のすき間に身体の一部を挟み込む等の重大な事故が発生しています。

介護ベッド用手すりは、製品の性質上、身体に関わる全ての挟み込みリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品の利用者及び利用者を介護する方は、取扱説明書安全使用マニュアル（医療・介護ベッド安全普及協議会編集）等に記載されている注意事項を今一度、確認して、挟み込みのリスクを認識し、正しく使用してください。

また、平成21年3月に介護ベッドの日本工業規格（JIS）が改正され、頭部や首の挟み込み事故を防ぐためのすき間の基準強化が図られています。安全のため、可能な限り改正されたJISに対応した製品を御使用ください。

特に、介護ベッド上で予測できない行動をとる可能性がある利用者や、自力で危ない状態から回避することができない利用者には、介護される方において、事業者の配布する簡易部品を入手されるなどすき間を埋めることで事故を防止するための工夫をしてください。

各製造事業者は、すき間を埋めるための部品を配布しています。すき間に頭部などが入り込むおそれのある製品を使用している場合は速やかに製造事業者と連絡し、簡易部品を入手した上で、必ず取付けて使用してください。その他、



製品の使用に際して、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又販売事業者等に相談してください。

医療・介護ベッド安全普及協議会 会員企業

- ・シーホネンス株式会社  
電話 : 0120-20-1001  
ホームページ : <http://www.seahonence.co.jp/>
- ・パラマウントベッド株式会社  
電話 : 0120-36-4803  
ホームページ : <http://www.paramount.co.jp/>
- ・株式会社プラッツ  
電話 : 0120-77-3433  
ホームページ : <http://www.platz-ltd.co.jp/>
- ・フランスベッド株式会社  
電話 : 0120-39-2824  
ホームページ : <http://www.francebed.co.jp/>
- ・株式会社モルテン  
電話 : 03-3625-8510  
ホームページ : <http://www.molten.co.jp/health>
- ・株式会社ランダルコーポレーション  
電話 : 048-475-3662  
ホームページ : <http://www.lundal.co.jp/>


**【本件に係る連絡先】**

消費者庁消費者安全課 担当：中嶋、服部  
電話：03-3507-8800（大代表） 内線2266




介護ベッド用手すり（管理番号：A201000531）


（製品本体）

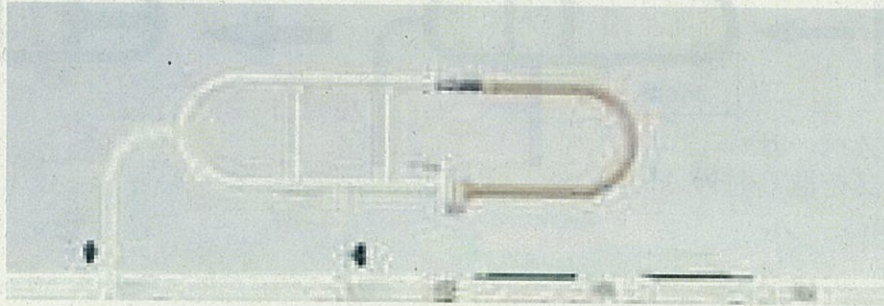

（ベッドへの取り付け図）

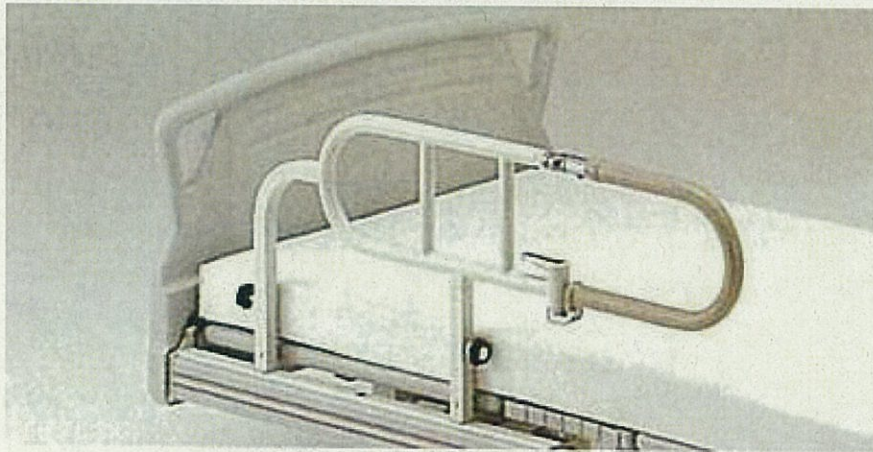

（すき間を埋めるためのT字型簡易部品）

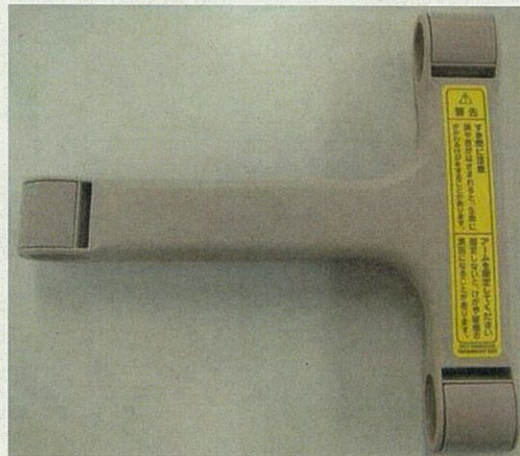




(簡易部品の装着後の図)



(平成21年のJIS規格改訂後の製品)

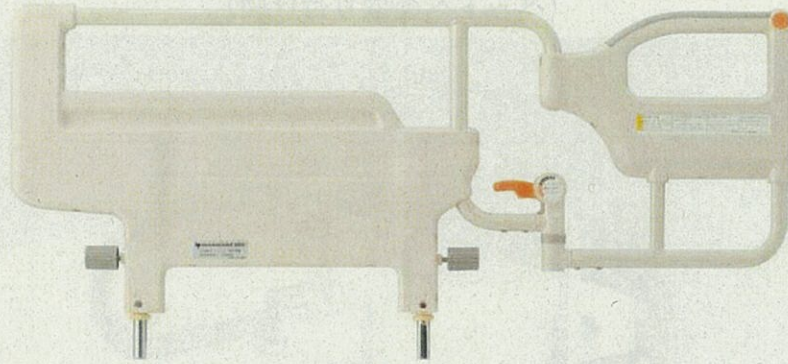



保存版

# 介護ベッド ここが危ない!!

あなたの介護ベッドに危険なすき間が潜んでいる?



## ご注意!

誤使用や想定外の使い方により介護ベッドの事故が増加しています。

### 今すぐ確認と対策を!

発行

医療・介護ベッド安全普及協議会




# 介護ベッドまわりの事故の現状

**ここが危ない!**

近年、介護ベッド関連の死亡・重傷事故が増えています。事故の多くは危険な部分があるかどうかの確認と正しい使い方によって未然に防ぐことができます。

## サイドレール関連 36件

- A** サイドレール内のすき間
- B** サイドレールとサイドレールのすき間
- C** サイドレールとボードのすき間
- D** サイドレールとマットのすき間
- E** ベッド用グリップの固定レバーなど

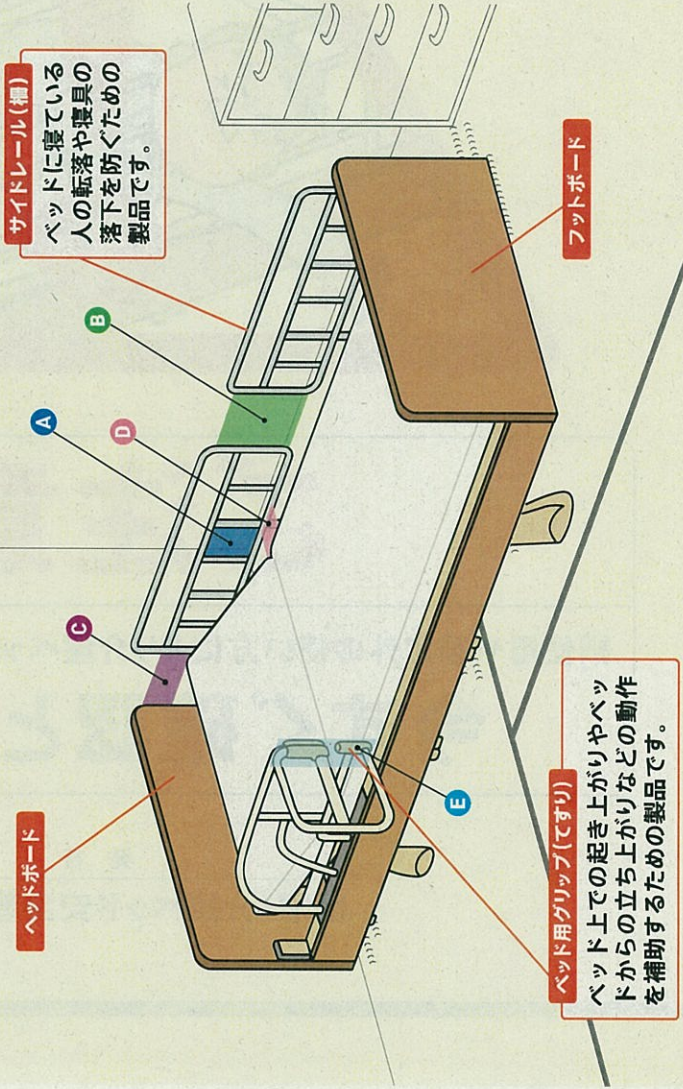

ベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がりなどの動作を補助するための製品です。

サイドレール(柵)に寝ている人の転落や寝具の落下を防ぐための製品です。

# こんな事故が起きています

サイドレール・ベッド用グリップのすき間の事故

**15件**

サイドレールの中に頭、腕や足が入り重傷・死亡した。



- 頭、首が入った
- 腕が入った
- 足が入った
- 揉んだ状態で「起き上がろうとした」「体をねじった」

**5件**

サイドレールとサイドレールのすき間に首がはさまり重傷・死亡



- ヘッドとサイドレールのメーカーが違う
- サイドレールとベッド(マットレス)のすき間

**4件**

サイドレールとボードのすき間に首がはさまり重傷・死亡した。



- ベッド用グリップを逆に取り付けていた。

**3件**

サイドレールとマットやベッドフレームの間に首がはさまり重傷をおった。



- 90cm幅対応のベッドに83cm幅のマットを使用した
- ヘッドとサイドレールのメーカーが違う

**3件**

着衣がベッド用グリップの固定レバーに引っかかり窒息により死亡。



この部分に引っかかる  
**3件** その他

**3件**

首振りの固定レバーが外れ、転倒・骨折した。



この部分の未固定によるもの

**13件**


ベッド本体と他の物とのすき間にはさまれた事故、ベッドのフレーム内にはさまれた事故。



その他介護ベッドの事故

## ★事故多発時間帯

事故の多くは夜から朝に起きています。



身体や意識がはきりしない時間帯にトイレに行こうとして、ベッドからの転落や移動中の転倒事故が多発します。特に服薬を服用している場合は身体状況が不安定になり転倒しやすくなります。医師の指導を守って下さい

■ 2007年5月14日～2010年8月31日集計  
消費生活用製品安全法に基づく重大事故として報告されたもの  
※ 重大事故：死亡、負傷または疾病であってこれらの治療に要する期間が30日以上等  
■ 経済産業省による調査の結果、36件中22件が「製品に起因しない事故」と判断されています。

## 夜10時～朝8時



# あなたの注意で事故は未然に防げます。チェックリストで確認を!!


き間  チェック①!

認知機能障害など予測できない行動をとる方や片マヒなどの障がいがある方、特にサイドレールのすき間などに注意して下さい。

すき間に首が入り込む事故が多発しています。




サイドレールとサイドレールのすき間

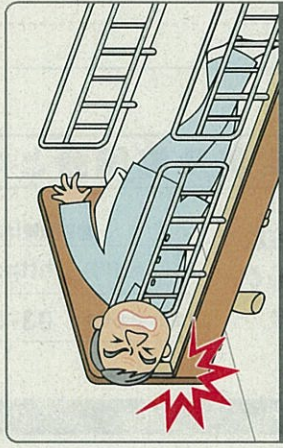

ボードとサイドレールのすき間

護ベッドのJIS規格では、図のようにサイドレールとサイドレールのすき間に直径6cmの硬い円柱状の器具が入らないこととされています。

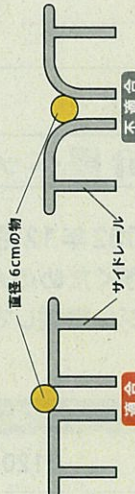

【してみよう】 安全確認スケールを当てて、直径6cmの物が入りそうなく確認しましょう。

## すき間があるときの解決策

ボードとサイドレールのすき間をクッションなどを入れてうめましょう。

ベアサーなどによりサイドレールとサイドレールの間にはさまらないようにしましょう。メーカーにより対応が異なります。詳しくはメーカーにご確認下さい



クッションなど



スペアサー

隙なすき間がないサイドレールに交換しましょう。

固定  チェック②!

ベッド用グリップの固定を確認していますか？

しっかり固定していないと……立ち上がるときに転倒し骨折する原因になります。




未固定による転倒・骨折

【実際にやってみよう!】


首振り機構の固定、ベッドへの固定は確實ですか？

その他  チェック③!

●取扱説明書をよく読んで正しく使いましょ。

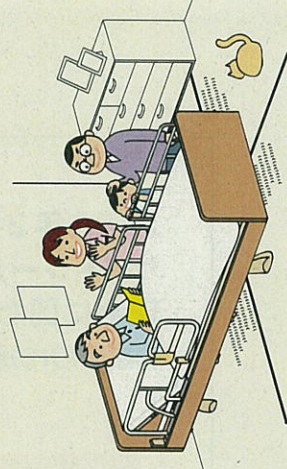

12cm以上のすき間があると……サイドレールの中に頭が入り、窒息事故が発生しています。

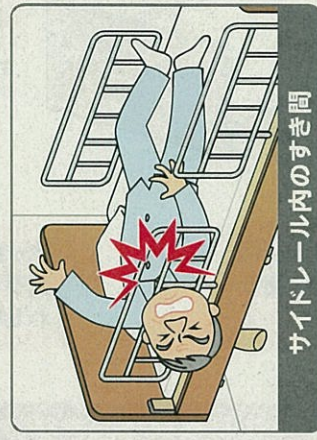


サイドレール内のすき間


【確認してみよう】

安全確認スケールを当てて、直径12cmの硬い物が入るすき間がないか計測しましょう。

## すき間があるときの解決策



サイドレールカバー



ベッド用グリップカバー

をご利用ください。


※メーカーにより対応が異なります。詳しくはメーカーにご確認下さい

安全確認スケール

すき間確認にご利用ください。

6cm

12cm






# 最新のベッドはどうなっているの？

JIS T9254:2009



【JISマーク表示例】

2009年3月に介護ベッドのJIS規格が改定され、サイドレールとサイドレールのすき間だけでなく、安全に関わる数十項目が厳しく規定されました。代表例 (JIS規格文を要約しています)

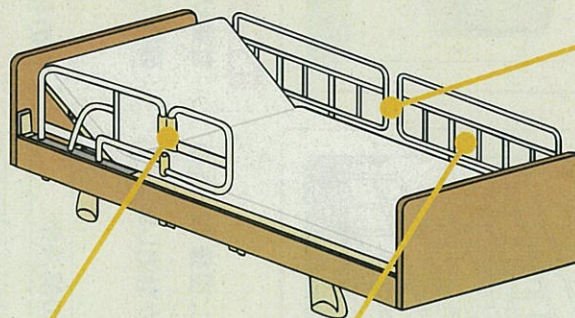

衣服が絡みつくような形状でないこと。

サイドレールとサイドレール、サイドレールとボードのすき間は直径6cmの物が入り込まないこと、もしくは23.5cm以上であること。

注1：詳しくは本パンフレット中面のチェック①をご覧ください。

ベッド用グリップの開閉テストで1万回をクリアすること。

サイドレール内の空間は直径12cmの物が通らないこと。

ベッドとサイドレール、ベッド用グリップの適合する組み合わせを明確にすること。

## 最新の JIS マーク付きのベッドでは事故は起きないの？

JIS マーク付きの製品は、その製品が一定の品質や性能を確保していることを証明するものですが、使い方を誤ると重傷や死亡に至る事故は発生します。取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。

## 医療・介護ベッド安全普及協議会とは

医療介護ベッドのメーカーにより 2002年12月に設立されました。ベッドを安心して使用して頂くためのハンドブックやマニュアルを作成し、ホームページに掲載しております。

最新情報はこちらからご確認下さい

【ホームページ】 <http://www.bed-anken.org>

【お問い合わせ先】 03-3648-5510

■ 協議会会員名簿 (あいうえお順)

協議会会員名	お問い合わせ先	ホームページ
シーホネンス株式会社	0120-20-1001	<a href="http://www.seahonence.co.jp/">http://www.seahonence.co.jp/</a>
パラマウントベッド株式会社	0120-36-4803	<a href="http://www.paramount.co.jp/">http://www.paramount.co.jp/</a>
株式会社プラッツ	0120-77-3433	<a href="http://www.platz-ltd.co.jp/">http://www.platz-ltd.co.jp/</a>
フランスベッド株式会社	0120-39-2824	<a href="http://www.francebed.co.jp/">http://www.francebed.co.jp/</a>
株式会社モルテン	03-3625-8510	<a href="http://www.molten.co.jp/health">http://www.molten.co.jp/health</a>
株式会社ランダルコーポレーション	048-475-3662	<a href="http://www.lundal.co.jp">http://www.lundal.co.jp</a>

**お使いのベッドのお問い合わせは各メーカーへ！**